

Busko – Zdrój, dnia 04 marca 2022 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku –Zdroju** z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz.1129 ze zm.). Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.03.2022 r., numer ogłoszenia 2022/BZP 00071048/01.

Odpowiedzi na zapytania nr 1

Do wszystkich Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu.

Zapytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści krem do pielęgnacji suchej i podrażnionej skóry, mający w składzie m.in. bisabolol i allantoinę, opakowanie =150 ml, z przeliczeniem zamawianej ilości sztuk. Tj. 800 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści krem z tlenkiem cynku w opakowaniu =1-ml, z przeliczeniem zamawianej ilości sztuk tj. 1200 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści piankę o pojemności 400 ml, z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 13125 sz.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 4 dotyczy Załącznik nr 1 Pozycja nr 5,6,7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12szt przyłepców z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 5 dotyczy Załącznik nr 1 Pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt opatrunków z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 5 dotyczy Załącznik nr 2 Pozycja nr 1,5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'30szt z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 6 dotyczy Załącznik nr 2 Pozycja nr 2,7,8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 7 dotyczy Załącznik nr 2 Pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 8 dotyczy Załącznik nr 2 Pozycja nr 4,6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 9 dotyczy Załącznik nr 3 Pozycja nr 4-6

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej wadze +/-15% od wartości wymaganej wg SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 10 dotyczy Załącznik nr 3 Pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o rozciągliwości min. 90%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 11 dotyczy Załącznik nr 3 Pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną z 1 zapinką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 12 dotyczy Załącznik nr 3 Pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o dużej zawartości bawełny, o składzie: 72% bawełny, 26% przędzy poliamidowej, 2% przędza poliuretanowa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 13 dotyczy Załącznik nr 3 Pozycja nr 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za watę celulozową pakowaną a'5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 14 dotyczy Załącznik nr 4 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 15 dotyczy Załącznik nr 5 Pozycja nr 1-2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opaski gipsowej z czasem wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 16 dotyczy Załącznik nr 5 Pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12szt z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 17 dotyczy Załącznik nr 5 Pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6szt z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 18 dotyczy Załącznik nr 9 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. W jednym opakowaniu mają być 2 sztuki. Opakowanie zbiorcze dowolne.

Zapytanie nr 19 dotyczy Załącznik nr 10

Wszystkie pozycje kompresów - Czy Zamawiający dopuści wagi kompresów +/- 15% od wymaganych w SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 20 dotyczy Załącznik nr 10 Pozycja nr 1, 2

Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 1m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymiary gazy mają być 1 mx1m.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/10/2022

Zapytanie nr 21 dotyczy Załącznik nr 10 Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną po 1 sztuce z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 22 dotyczy Załącznik nr 10 Pozycja nr 3-6

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12N?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 23 dotyczy Załącznik nr 10 Pozycja nr 7-8

Czy Zamawiający dopuści opaski niejätowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 24 dotyczy Załącznik nr 10 Pozycja nr 7-8

Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane w opakowanie papierowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem, że na zewnątrz opakowania musi być centralna etykieta z dwoma samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej.

Zapytanie nr 25 dotyczy Załącznik nr 10 Pozycja nr 7-8

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby opakowanie posiadało etykiety samoprzylepne.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od powyższego wymogu.

Zapytanie nr 26 dotyczy Załącznik nr 10 Pozycja nr 9

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane po 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 27 dotyczy Załącznik nr 10 Pozycja nr 14

Czy Zamawiający dopuści pakiet zabiegowy do laparotomii z tupferami RTG kule 15 x 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 28 dotyczy Załącznik nr 10 Pozycja nr 15

Czy Zamawiający dopuści pakiet zabiegowy do przepukliny z tupferami RTG kule 15 x 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 29 dotyczy Załącznik nr 10 Pozycja nr 14-17

Czy Zamawiający dopuści poniższe wagi pojedynczych kompresów 16W 17N RTG:

7,5 x 7,5 cm – 2,13g

10 x 10 cm – 3,71g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 30 dotyczy Załącznik nr 10 Pozycja nr 14-17

Czy Zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem etylenu? Proces sterylizacji tlenkiem etylenu jest równie bezpieczny jak sterylizacja parą wodną, ponieważ każdy rodzaj sterylizacji musi być zwalidowany, nadzorowany, kontrolowany zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązującymi normami dla danego rodzaju procesu sterylizacji.)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 31 dotyczy Załącznik nr 10 Pozycja nr 14-17

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 32 dotyczy Załącznik nr 10 Pozycja nr 20-22, 24

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Taki podział umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji 20-22, 24 do osobnego pakietu.


Zapytanie nr 33 dotyczy Załącznik nr 10 Pozycja nr 23

Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny w klasie I sterylnej, reg. 4?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 34 dotyczy Załącznik nr 13

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek z kieszenią do zabezpieczania cewników do dializ, w górnej części mocującej wykonana z samoprzylepnej, oddychającej i wodoodpornej folii poliuretanowej, oddychająca, nieklejąca kieszeń z zewnętrzną warstwą odporną na kontakt z wodą i drobnoustrojami, dolna część stabilizująca kieszeń wykonana z hdrofobowej włókniny, rozmiar 10x24cm?

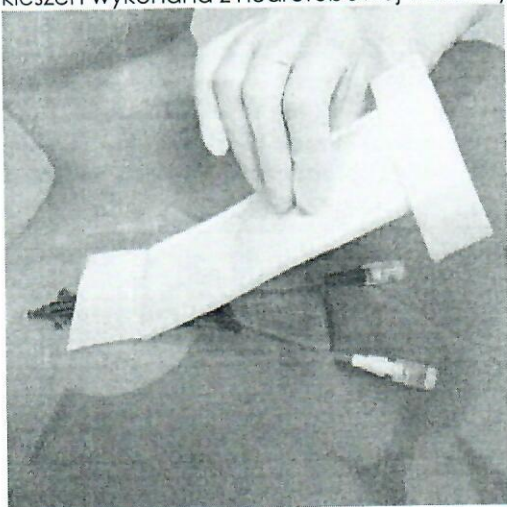

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 35 dotyczy Załącznik nr 14 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zabiegowy do znieczulenia z serwetą z laminatu o gramaturze 60g/m², rozmiar 75 x 90 cm z przylepnym otworem 6 x 8 cm (w miejsce serwety włókninowa 35g/m² o rozmiarze 80x60 z przylepnym, otworem 8cm i przylepcem na boku)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 36 dotyczy Załącznik nr 14 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zabiegowy do znieczulenia z serwetą foliowaną 60g/m² 90x75cm (w miejsce serwety foliowanej 39g/m² 90x75cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 37 dotyczy Załącznik nr 14 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowy do znieczulenia zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 38 dotyczy Załącznik nr 14 Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści pakiet jałowy do dializ pakowany w dwudzielny rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 39 dotyczy Załącznik nr 14 Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści pakiet jałowy do dializ z serwetą włókninową foliowaną 70 x 50 cm, 54g/m² (w miejsce serwety 60 cm x 50 cm 42 gr/m²)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/10/2022

Zapytanie nr 40 dotyczy Załącznik nr 14 Wymagania opisane pod pakietem

Czy Zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem etylenu? Proces sterylizacji tlenkiem etylenu jest równie bezpieczny jak sterylizacja parą wodną, ponieważ każdy rodzaj sterylizacji musi być zwalidowany, nadzorowany, kontrolowany zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązującymi normami dla danego rodzaju procesu sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 41 dotyczy Załącznik nr 1 Pozycja nr 1

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie zestawu równoważnego w składzie:

1szt serweta z otworem przylepnym, 75x90cm, otwór 6x8cm – serweta 2w PE+PP, 60g/m²

1szt narzędzie plastikowe do mycia (typu kocher) 14cm

10szt kompresów 7,5cm x 7,5cm 4 warstwowe z włókniny 30 g/m²

1szt serweta typu Hospidrape 44g/m² stanowiąca owinięcie zestawu

Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa z etykietą główną i 2 etykietami samoprzylepnymi

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 42 dotyczy Załącznik nr 1 Pozycja nr 2

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie zestawu równoważnego w składzie:

Rozpoczęcie (pierwsza komora):

3szt kompresów 7,5cm x 7,5cm 4 warstwowe z włókniny 30 g/m²

1szt serweta włókninowa foliowana 60 cm x 50 cm 44 g/m²

2szt włókninowy opatrunek 8cm x 6cm do mocowania kaniul z podkładką chłonną

Zakończenie (druga komora):

4szt kompresów 7,5cm x 7,5cm 4 warstwowe z włókniny 30 g/m²

Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa z etykietą główną i 2 etykietami samoprzylepnymi

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 43 dotyczy Załącznik nr 5 Pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie opaski gipsowej na podłożu bawełnianej gazy powleczonej naturalnym 94% gipsem o czasie wiązania 4-8 minut w rozmiarze 10 cm x 3 m ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 44 dotyczy Załącznik nr 5 Pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie opaski gipsowej na podłożu bawełnianej gazy powleczonej naturalnym 94% gipsem o czasie wiązania 4-8 minut w rozmiarze 15 cm x 3 m ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 45 dotyczy Załącznik nr 8 Pozycja nr 1

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompresów włókninowych 5x5cm, 30g, a'2szt sterylizowanych tlenkiem etylenu, w opakowaniu papier-papier zawierającym wszystkie dane identyfikujące produkt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 46 dotyczy Załącznik nr 6 Pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ZinoDr a 250g/op. co odpowiada objętości 200 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 47 dotyczy Załącznik nr 8

Czy można zaoferować kompresy włókninowe w opakowaniu papierowym sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju
ul Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko- Zdrój
tel. centrala 41 378 24 01
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467
e-mail: ekretariat@zoz.busko.com.pl
strona internetowa: www.zoz.busko.com.pl



Świętokrzyska Nagroda Jakości
Laureat XVI edycji SNJ
w kategorii organizacji
publicznych – ochrona
zdrowia

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZOZ/DO/OM/ZP/10/2022

Zapytanie nr 48 dotyczy Załącznik nr 8

Prosimy o odstąpienie od wymogu dotyczącego klasyfikacji kompresów włókninowych klasa IIa reguła 7 ze względu na fakt, iż taka klasyfikacja dotyczy wyrobów chirurgicznie inwazyjnych przeznaczonych do krótkotrwałego użytku (czas ciągły użycia nie dłużej niż 30 dni). Opis przedmiotu zamówienia sugeruje, iż wyrób ten będzie stosowany jako wyrób

nieinwazyjny (zaklasyfikowany do klasy I reguły 4, czyli jako nieinwazyjny wyrób, który wchodzi w kontakt ze zranioną skórą przeznaczony do użycia jako bariera mechaniczna do ucisku lub do absorpcji wysięków)

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.

Zapytanie nr 49 dotyczy Załącznik nr 8

Prosimy o sprecyzowanie, czy zamówienie dotyczy 600 000 opakowań po 2 sztuki, czy 600 000 sztuk kompresów??

Odpowiedź: Chodzi o 600 000 opakowań po 2 sztuki.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
mgr Grzegorz Lasak

Wyk. 3 egz.
Egz. Nr 1 Wykonawcy
Egz. Nr 2 a/a
Egz. Nr 3 BIP

DYREKTOR
Grzegorz Lasak
2022.06.10